Synovasure® PJI

Test de Alfa-Defensina para
infecciones articulares periprotésicas

zimmer
Personal Fit. Renewed Life.™

Cómo utilizarlo

1. Aspiración

Aspire el líquido sinovial de la articulación (cadera, rodilla, hombro) del paciente.

NO inyecte solución salina en la articulación antes de la aspiración.

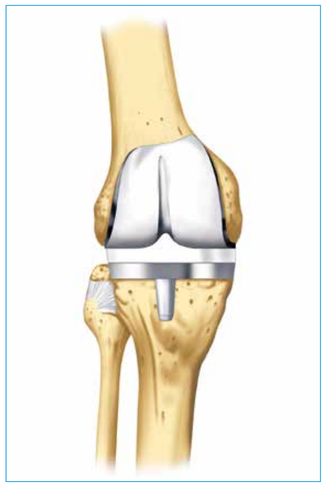

2. Frasco

Retire el tapón morado del frasco de dilución, y apártelo.

Introduzca el líquido sinovial de la jeringuilla en el frasco de muestras.

3. Tubo

Coloque un tubo Microsafe® seco **horizontalmente** en el frasco. El líquido llegará automáticamente hasta la línea negra por capilaridad.

NO presione la perilla del tubo. Deje que el líquido alcance la **línea negra**. Si el líquido es muy viscoso puede tardar más en llenar el tubo.

4. Dilución

Transfiera el líquido sinovial al frasco de dilución precargado. Presione la perilla varias veces para asegurarse de que sale todo el líquido. Vuelva a colocar el tapón en el frasco e inviértalo con cuidado para mezclar el contenido.

5. Dispositivo

Coloque el dispositivo sobre una superficie **plana**.
Aplique **3 gotas** de líquido sinovial diluido en el dispositivo de la Prueba *Synovasure* PJI.

Mantenga el dispositivo **plano** durante todo el proceso.

6. Obtenga el resultado

Ponga un temporizador para que le avise **10 minutos** después de la aplicación de las gotas, y transcurrido ese tiempo lea los resultados.

NO lea los resultados si han transcurrido más de 20 minutos.

Realizar la prueba a temperatura ambiente (15 – 30°C)

Microsafe® es una marca registrada de Safe-Tec Clinical Products.

Exención de responsabilidades
Este folleto está pensado exclusivamente para profesionales del ramo (es decir, particularmente para médicos) y es inadecuado para informar a personas sin conocimientos de medicina. La información relativa a los productos y los procedimientos descritos en el folleto es de naturaleza general y no representa ninguna forma de asesoramiento ni recomendación médica. Dado que dicha información no representa ningún tipo de declaración diagnóstica o terapéutica relativa a un caso médico específico, las explicaciones y el asesoramiento al cliente en cuestión será imprescindible y no podrán ser reemplazadas total ni parcialmente por el presente folleto. Por favor, consulte los prospectos para obtener información importante sobre el producto, incluyendo pero no limitada a las contraindicaciones, avisos, precauciones y reacciones adversas.

Lit.No. 06.02689.015 – Ed. 2014-08
+H84406026890151/$140801H14C

akralab
a tu lado desde 1987

www.akralab.es - 965 116 521/ 902 222 275
atencion.clientes@akralab.es